





6.3.4 การบ่งชี้สถานะบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างชัดเจนเป็นปัจจุบันและสืบค้นหา
ผลการตรวจสอบย้อนหลังได้

การบ่งชี้สถานะบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างชัดเจน





การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยหน่วยงาน

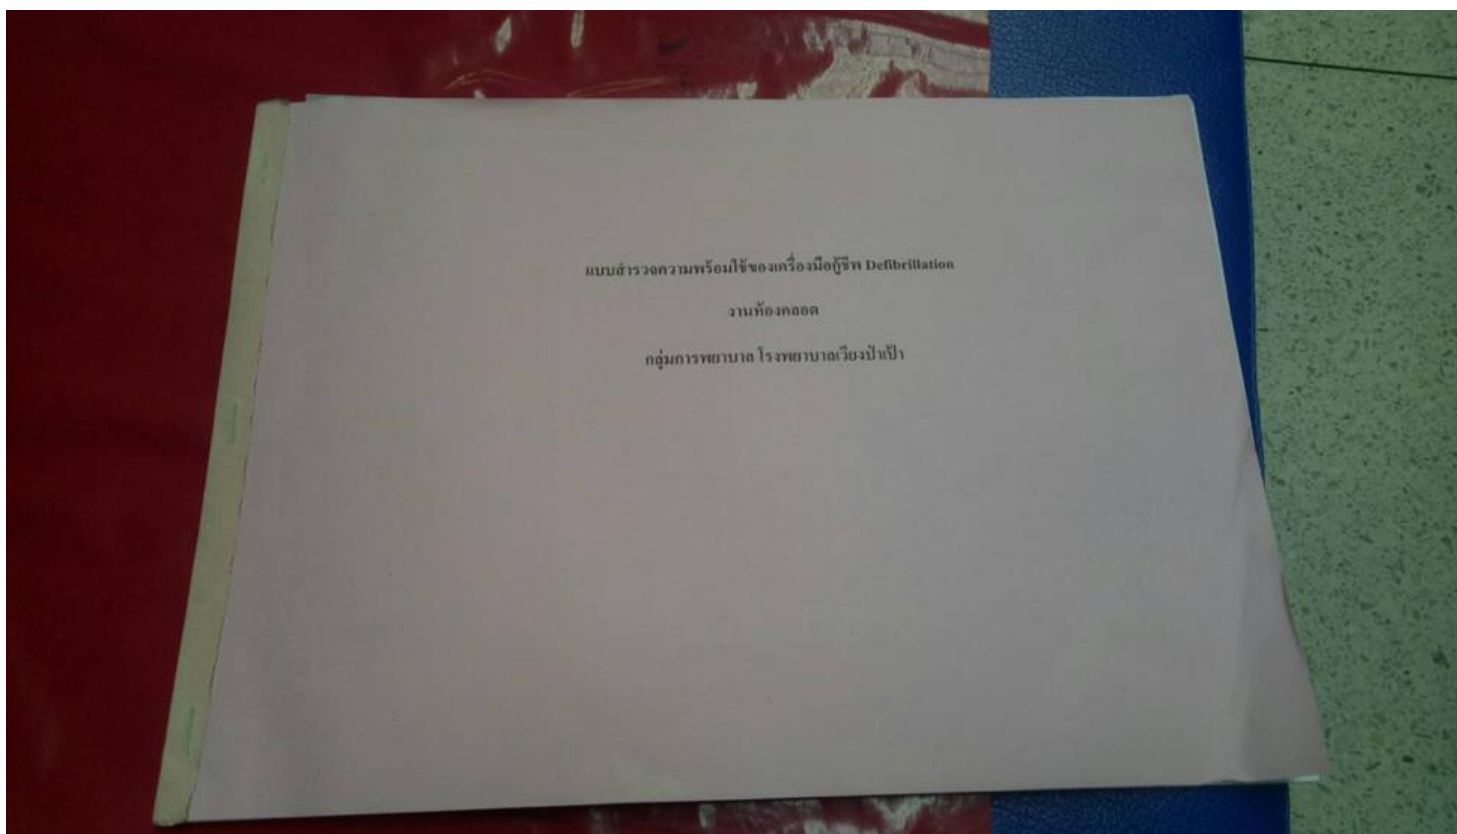



การตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ภายในหน่วยงาน

แบบสำรวจความพร้อมใช้ของเครื่องใช้ Defibrillation งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า


ประจำเดือน ๒๐ ๖๖

| ลำดับ | รายการ/วันที่ตรวจ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | เปิดใช้งานนำจอกที | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E |
| 2 | วันที่ เวลา เป็นปัจจุบัน | / | | | | | | | | | | | |
| 3 | ระดับแบตเตอรี่ | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | / | / | / | | | | | | | | |
| | 75% | | | | | / | | | / | | | | |
| | 50% | / | | | | | | | | / | | | |
| | 25% | | | | | | | | | | / | | |
| 4 | ความพร้อมของชุดของ paddle | | | | | | | | | | | | |
| | ผู้ใหญ่ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | เด็ก | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | External pacemaker | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | ความพร้อมของการ charge ใช้งานได้ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | ความพร้อมของการ shock | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | Charge Battery ทุกอัลตรา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | Test ทุกอัลตรา-บันทึกปริมาณพลังงานเข้า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | -บันทึกปริมาณพลังงานออก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | สาย Monitor EKG | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | Red Dot ใช้งานน้อย 3 ชิ้น | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | Electrode gel | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | ปลั๊กไฟ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | ทดสอบเสียบปลั๊กไฟที่ขั้วเครื่องมือ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | ลงชื่อ | | | | | | | | | | | | |






ทะเบียนหรือประวัติการบำรุงรักษาของเครื่องมือแพทย์ในระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน

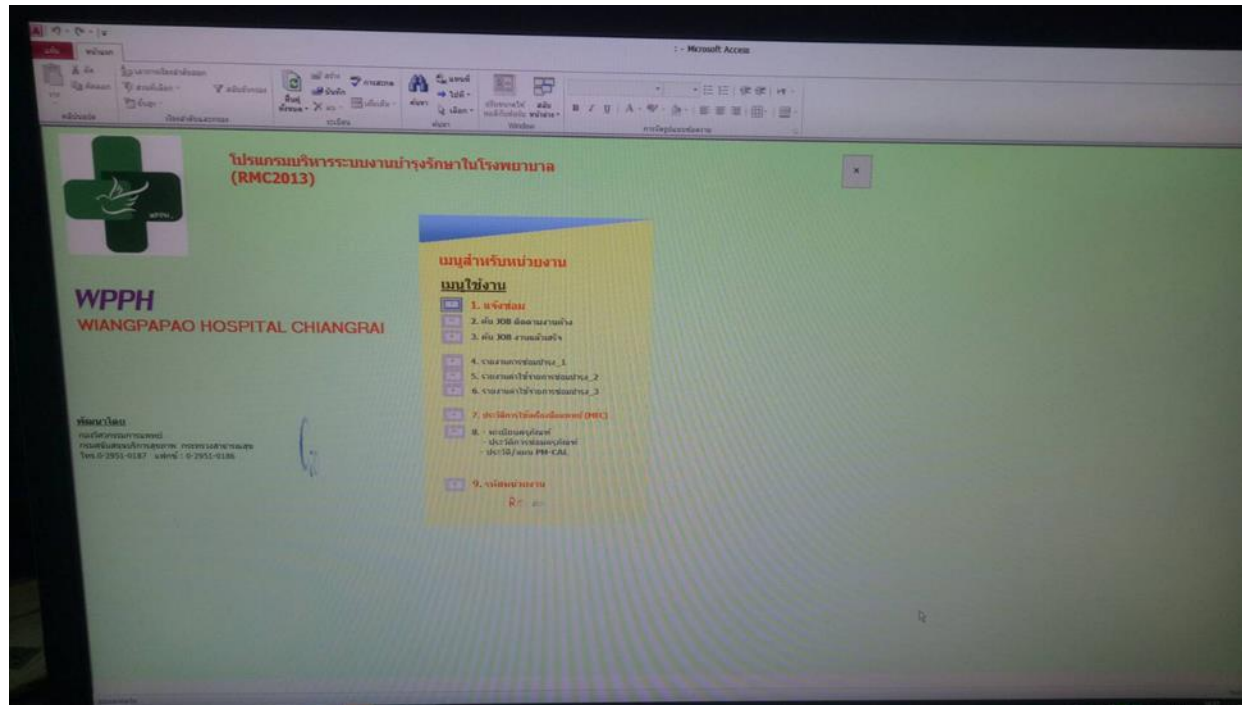



ข้อมูลหรือประวัติการบำรุงรักษาของเครื่องมือแพทย์สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

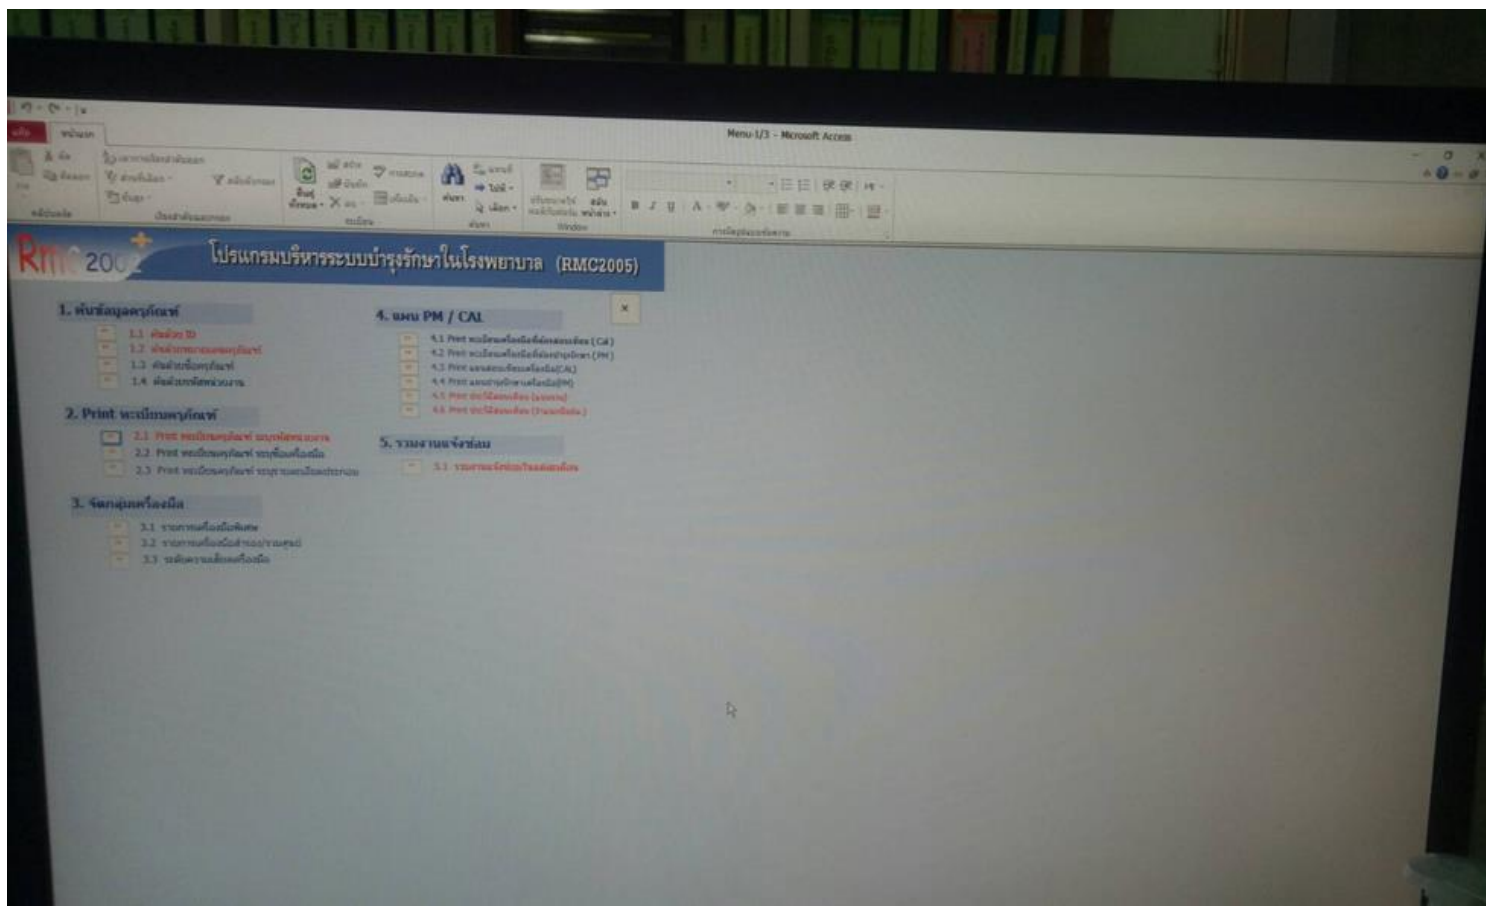

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
Wiang Pa Pao Hospital